



CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, Budynek 20A,
tel./fax 22/841-58-34; e-mail: sprawdzian@polmicro.edu.pl

Koordinator Programu POLMICRO/MIKOLOGIA

Prof. dr hab. med Waleria Hryniewicz

Dyrektor Centralnego Ośrodka
Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
tel. 22 460 82 52; fax 22 851 52 06

OŚR.4150.5.2020.1.31.26M02

Warszawa, 18.08.2020

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z Programu POLMICRO 2020/MIKOLOGIA runda I

Laboratorium:

SLW BIOLAB Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne spółka cywilna
SLW BIOLAB Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne spółka cywilna
14-100 Ostróda
ul. Grunwaldzka 62

Ocena końcowa w rundzie I z II zaplanowanych na 2020 rok :

pozytywna

$z = 0.0$

Łączna liczba punktów: 10

Możliwa maksymalna liczba punktów: 10

Odchylenie standardowe: 1.14

Ocena szczegółowa:

Laboratorium otrzymało w ramach I rundy POLMICRO/MIKOLOGIA 2020 następujące obiekty badania:

Szczep A - *Candida glabrata* PM-412

Szczep B - *Candida parapsilosis* PM-411

Czas przechowywania 20 dni w temperaturze pokojowej oraz transport próbek nie miał wpływu na ocenę obiektów badania. Jednorodność obiektów badań została potwierdzona.


Tabela 1. Wyniki laboratorium

Obiekt badania	wynik referencyjny	podano	ocena
Szczep A	<i>Candida glabrata</i>	<i>Candida glabrata</i>	5
Szczep B	<i>Candida parapsilosis</i>	<i>Candida parapsilosis</i>	5

Tabela 2. Kryteria oceny I runda POLMICRO 2020/MIKOLOGIA

Wartość przypisana X	maksymalna liczba punktów	X=10
Odchylenie standardowe	wyliczone z wyników uczestników	$\sigma=1,14$
Średnia liczba punktów zdobytych przez uczestników	wyliczone z wyników uczestników	10 pkt
wskaźnik „z”	z-score	liczba laboratoriów n (%)
	$ z \leq 2$ ocena pozytywna	n=128 (97%)
	$2,0 < z < 3,0$ ocena warunkowo pozytywna	n=0 (0%)
	$ z \geq 3,0$ ocena negatywna	n=4 (3%)

Wykres 1. Wartość wskaźnika „z” dla laboratoriów biorących udział w I rundzie POLMICRO 2020/MIKOLOGIA

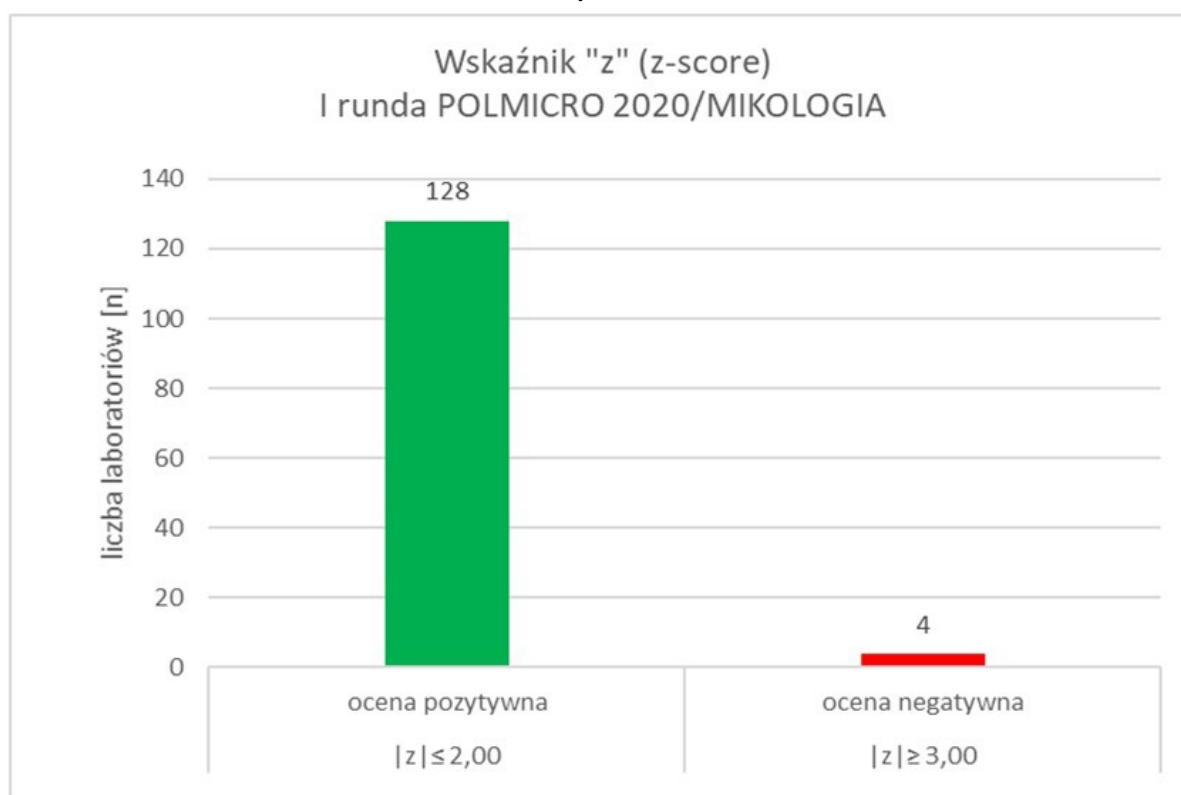

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej współpracuje z firmą Soft-Tech s.c. A.P. Kotowscy w zakresie obsługi strony internetowej COBJwDM oraz realizacji etapu internetowego Programu POLMICRO/MIKOLOGIA.

Określono zasady postępowania na etapie pozyskiwania, przechowywania i wykorzystywania informacji, które gwarantują ich poufność, ochronę prawa własności i danych osobowych Klienta. Zasady bezpieczeństwa danych dotyczą zarówno danych fizycznych, jak i systemów elektronicznych. Tożsamość uczestników programu znana jest jedynie osobom włączonym w realizację programu POLMICRO/MIKOLOGIA. Sprawozdania zawierające wyniki Laboratorium są dostępne jedynie zainteresowanemu Laboratorium po uprzednim zalogowaniu się na stronie Organizatora z wykorzystaniem indywidualnego kodu oraz hasła.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej przekazuje Ministerstwu Zdrowia kwartalne i roczne raporty z działalności Ośrodka oraz listę Laboratoriów, które w danym roku kalendarzowym brały udział w Sprawdzaniu i otrzymały Świadectwo lub Zaświadczenie.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

W przypadku wykorzystania uzyskanych wyników w publikacjach i sprawozdaniach, udostępniane są wyłącznie zbiorcze dane statystyczne.

Bez pisemnej zgody Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wszelkie informacje związane z realizacją programu POLMICRO/MIKOLOGIA można znaleźć na stronie internetowej www.polmicro.edu.pl.

Osoba autoryzująca sprawozdanie:

/-/ Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Dyrektor Centralnego Ośrodka
Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
Koordynator programu POLMICRO/MIKOLOGIA

Koniec Sprawozdania POLMICRO 2020/I/M